


Zkušební parametry

Zkušební norma: r-und n-Wert-Bestimmung
Typ stroje: LabTest 5.100SP1
Snímač síly: 100kN
Průtahoměr: extenzome
Upínací přípravek: ne
Zkušební prostor: Spodní zkušební prostor
Rozměry vzorku: a = 1,34 mm; b = 20,53 mm; h = 1 mm; m = 1 g
Zadání délky: Le = 80,4 mm; Lc = 100 mm; LO = 100 mm
Zkušební rychlosti: V0 = 10 mm/min; V1 = 10 mm/min
Přepínací body: F0 = 500 N
Kriterium ukončení zkoušky: Síla = 98000 N; dF = 70 %

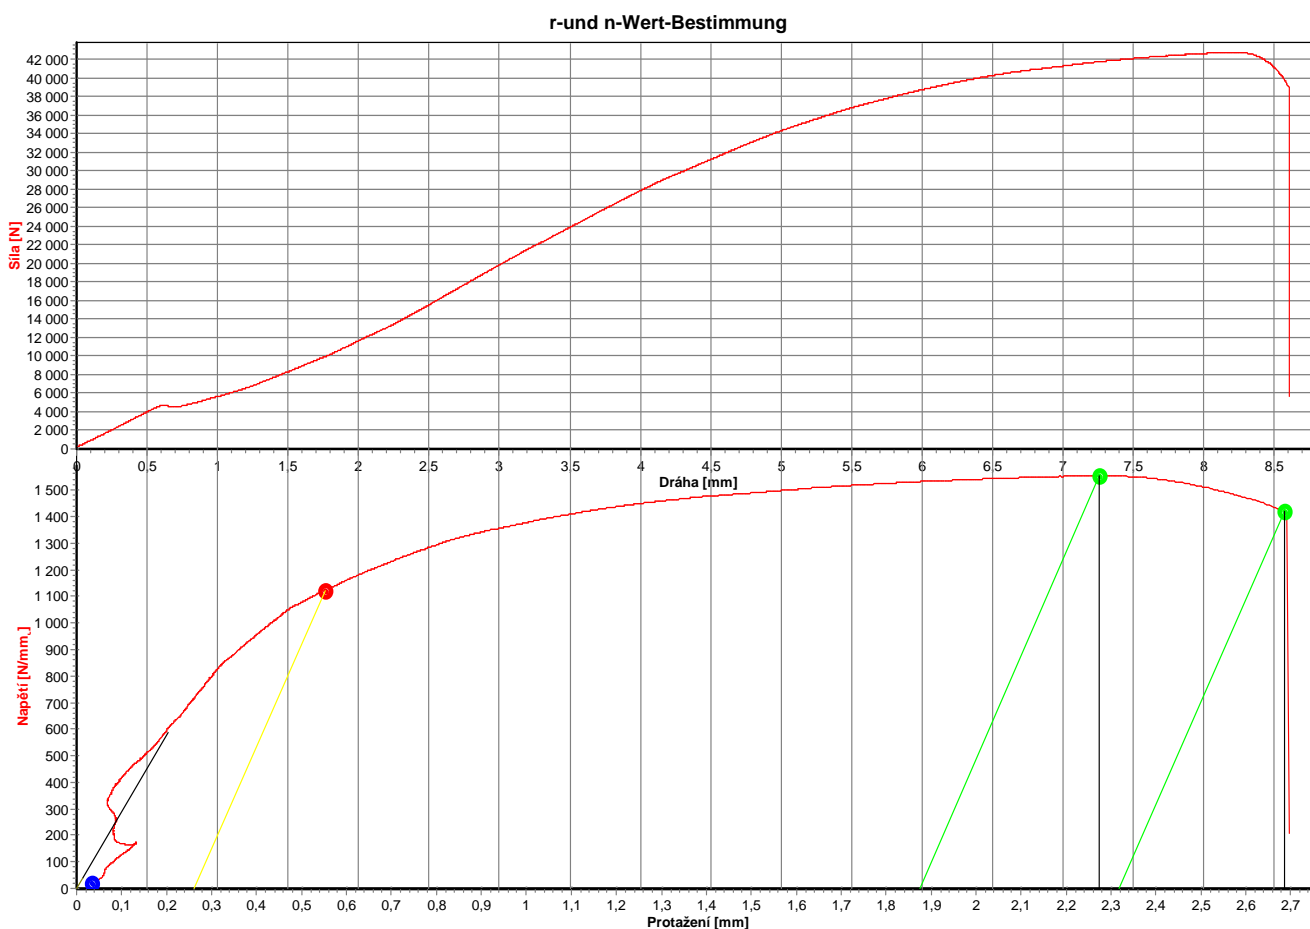

Tabulka výsledků

	E kN/mm ₂	Rp1 N/mm ₂	Fp1 N	ReH N/mm ₂	ReL N/mm ₂	Rm N/mm ₂	Fm N	Fb N	Ag %
1	230,784	1122,10	30869,20	0,00	0,00	1554,48	42764,10	39106,10	2,16

	A %	Ag _t %	At %	Su mm	Z %	r	n	Lu mm	S0 mm
1	2,19	2,83	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51

	a mm	b mm
1	1,34	20,53

Statistika a = 1

	E kN/mm _e	Rp1 N/mm _e	Fp1 N	ReH N/mm _e	ReL N/mm _e	Rm N/mm _e	Fm N	Fb N
Střední hodnota	230,784	1122,10	30869,20	0,00	0,00	1554,48	42764,10	39106,10
Standardní odchylka	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variační koeficient	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ag %	A %	Agt %	At %	Su mm _e	Z %	r	n
Střední hodnota	2,16	2,19	2,83	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardní odchylka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variační koeficient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Lu mm	S0 mm _e	a mm	b mm	
Střední hodnota	0,00	27,51	1,34	20,53	
Standardní odchylka	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variační koeficient	0,00	0,00	0,00	0,00	